

BİR YUMUŞAK ASTAR MADDESİNİN FARKLI AKRİLİK PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNE BAĞLANMA DAYANIMI

Ömer Kutay**, Tayfun Bilgin***, Olcay Şakar****

Yayın kuruluna teslim tarihi: 15. 1. 1993

ÖZET

Bu araştırmada yumuşak astar maddesi Moloplast-B'nin akrilik protez kaide materyallerine bağlanma dayanımı çekme deneyi metodu ile incelenmiştir. Deney örnekleri hazırlanırken Moloplast-B'nin bağlılığı Lucitone 199, Pacton ve Meliodent akrilik reçine yüzeyleri polimerize edilmemiş halde ve ayrıca polimerize pürüzlü yüzeyler hâlinde hazırlanmıştır. Ivocap ve Compressin'in yüzeyleri ise polimerize edilerek pürüzlendirilmişlerdir. Bağlanma dayanım ölçümleri Universal Instron test cihazında, sabit bir deformasyon hızıyla gerçekleştirilmiştir. En az bağlanma dayanımını 7.61 kg/cm^2 ile Lucitone, en fazla bağlanma dayanımını ise 12.91 kg/cm^2 ile Meliodent göstermiştir. Sonuç olarak Moloplast-B'nin, kırılma dayanımı yüksek olan akrilikler dışında diğer tür akriliklerle de yeterli bağlanma sağlayabilecegi ve polimerize edilmiş akriliklerin pürüzlendirilmesinin bağlanmayı güçlendirdiği saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Yumuşak astar maddeleri, protez kaide akriliği, bağlanma dayanımı.

GİRİŞ

Yumuşak astar maddeleri çığneme kuvvetlerinin protez kaidesi altında eşit dağılımını sağlayarak streslerin belirli bölgelerde yoğunlaşmasını engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca elastik özellikleri sayesinde doku undercutlarını geçerek protezin retansiyonunu artırmaktadırlar (7).

Literatürde yumuşak astar maddelerinin, akrilik protez kaidesine zayıf bağlanma gösterdiğini ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır (1,2,3,4,6,7,8,9,11,13). Bu araştırmalar çeşitli yumuşak astar maddelerinin adezyon kuvvetlerinin değişkenlik gösterdiğini bildirmektedirler. Diğer taraftan Fowler (6) tarafından

ABSTRACT

BOND STRENGTH OF A RESILIENT LINER TO DIFFERENT ACRYLIC RESIN DENTURE BASE MATERIALS

In this investigation bond strength of Moloplast-B resilient liner to various acrylic resin denture base materials was evaluated by using a tensile bond strength procedure. Lucitone 199, Pacton and Meliodent acrylic resin surfaces were processed as uncured and smooth versus pre-cured and roughened before bonding with Moloplast-B. Ivocap and Compresin resins were pre-cured and roughened prior to bonding. Tensile bond strengths were measured using an Universal Instron testing machine at a constant rate of 2 mm/min. Lucitone showed the lowest mean bond strength value (7.61 kg/cm^2), Meliodent exhibited the highest mean bond strength value (12.91 kg/cm^2). It was concluded from this study that sufficient bond strength can be achieved with use of unconventional acrylic resins with resilient liners and the bonding was improved by roughening the pre-cured acrylic resin surfaces.

Key words: Resilient denture liners, acrylic denture base resin, bond strength.

yapılan bir çalışmada, farklı türdeki akrilik kaide maddelerinin, yumuşak astar maddelerine olan bağlanma dayanımlarının da değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Ancak bu konu yeterince açılığa kavuşmamıştır.

Yumuşak astar maddeleri, kırılma direnci yüksek (butadiene veya styrene rubber reinforced) akrilik reçineler ile birlikte kullanılmalarının yanı sıra, konvansiyonel akrilik reçinelerden yapılmış protezlere de astarlanabilmektedirler.

Bu çalışmada farklı akrilik reçineler kullanılarak yapılan protezlerin yumuşak astar maddelerine bağlanma dayanımları incelenmiştir.

** Yrd. Doç. Dr. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

*** Dr. Med. Dent İ.Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

**** Doktora Öğr. İ. Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmamızda akrilik protez kaide maddeleri olarak Pacton, Lucitone 199, Meliodent, Ivocap ve Compresin kullanıldı (Tablo I). Pacton ve Lucitone 199 kırılma direnci yüksek akrilik reçinelerdir. Meliodent konvansiyonel çapraz bağlı akrilik reçine; Ivocap basınçlı enjeksiyon teknigiyle kullanılan akrilik reçine türündür. Compresin ise otopolimerizan dokülebilir, sıvı bir akrilik reçinedir. Kullanılan akrilik protez kaide maddeleri tüm gruplarda Moloplast-B yumuşak astar maddesi ile bağlanmış ve bağlanma dayanımları bir çekme gerilimi deney metodu ile incelenmiştir.

Tablo I : Kullanılan Materyaller

Materyal	Türü	Firma	Seri No.
- Lucitone 199	Kırılmaya dirençli PMMA	Dentsply Int. U.S.A.	072386
- Pacton	Kırılmaya dirençli PMMA	Biolux Int. Belgium	68304
- Meliodent	Kovansiyonel PMMA	Bayer Dental Germany	ON1247
- Ivocap	Enjeksiyon basınçlı PMMA	Ivoclar AG Germany	366016
- Compresin	Otopolimerizan PMMA	Krupp-Germany	6279950
- Moloplast-B	Silikon esası yumuşak astar	Molloplast-Regneri and Co.KG, Germany	870420


PMMA=Polimetil metakrilat akrilik reçine

Her bir deney grubu 9 adet deney örneğinin bir muflada hazırlanmasıyla elde edilmiştir. Örneklerin hazırlanması için 18 adet piramit şekilli pirinçten yapılmış kalıp hazırlayıcı parçalar kullanılmış ve bunlar 10x10 mm ve 12x12 mm boyutlarındaki taban kısımlarından 60x60x3 mm boyutlarında bir pirinç plakaya simetrik olarak yapıştırılmış ve bütün olarak alçıya (*) alınmıştır. Simetri, freze de yapılmış ayrı bir aparey ile sağlanmıştır.


Pirinç parçalar alçıdan çıkarılarak piramit şekilli blokların yerine akrilik reçineler preslenmiştir (Resim 1) ve (Resim 2). Bu safhada akrilik reçineler iki gruba ayrılmıştır. I. Grupta, tüm akrilik reçineler polimerize edilmiş ve pürüzlendirilmiştir. II. Grupta, Me-

liodent, Lucitone ve Pacton akrilik reçineler polimerize edilmeden Moloplast-B ile bağlanmıştır. Polimerize edilmemiş akrilikler 24 saat presde bırakılarak, Moloplast preslenmeden önce akrilik reçinenin şekil değiştirmeyecek bir kıvama gelmesi sağlanmıştır. Compresin ve Ivocap akriliklere bu işlem uygulanmadığından II. Grupta yer almamışlardır. 3 mm kalınlığındaki plaka 24 saatlik pres de bekleme süresince mufladaki yerinde bırakılmıştır. Pacton, Lucitone, ve Meliodent'in adezyon yüzeyleri polimerize edilmeden düzgün olarak hazırlanmıştır. I. Grupta polimerize edilen Meliodent, Pacton ve Lucitone'un adezyon yüzeyleri ise 100 grid'lik su zımparasıyla (*) pürüzlendirilmiştir.

Resim 1. Pirinç parçaların alçıdan çıkartılması

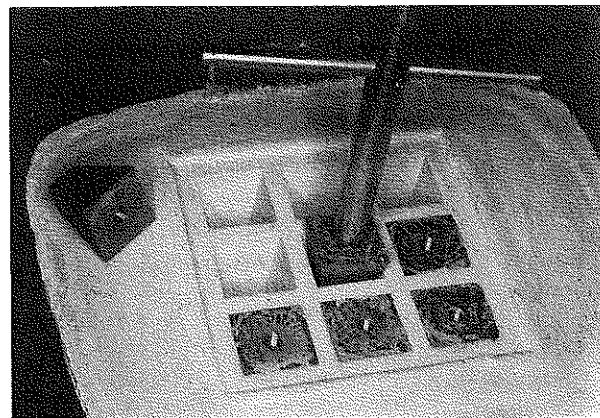

Resim 2. Mufladan çıkarılan blokların yerine akrilik reçinin preslenmesi

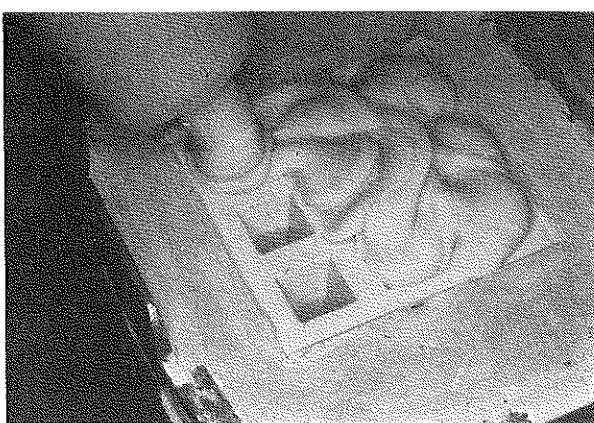


Polimerize edilmiş akrilik yüzeylere Moloplast-B'nin Primo(**) isimli adezivi sürülmüştür. 3 mm kalınlığındaki plakanın yerine Moloplast-B yumuşak

(*) Waterproof silicon carbide paper, England.

(**) Moloplast-Regneri and Co. KG, Germany

astar maddesi preslenerek örnekler bu materyalin direktiflerine uygun olarak polimerize edilmişlerdir. Mufladan çıkartılan ve tesviye edilen örneklerde Universal Instron test cihazında 2 mm/dak lık bir sabit deformasyon hızında çekme gerilimi uygulanmıştır (Resim 3). Bağlanma dayanımları kg/cm² cinsinden birim alana gelen stresler hesaplanarak kaydedilmiştir. Ayrıca örneklerde maksimum çekme gerilimi sonucunda görülen kopma şekli adesiv veya kohesiv olarak saptanmıştır. Veriler tek yönlü varyans analizi ile ve 0.05 yanılma olasılığında Tukey testi ile değerlendirilmiştir (10).

Resim 3. Instron cihazında çekme geriliminin uygulanması

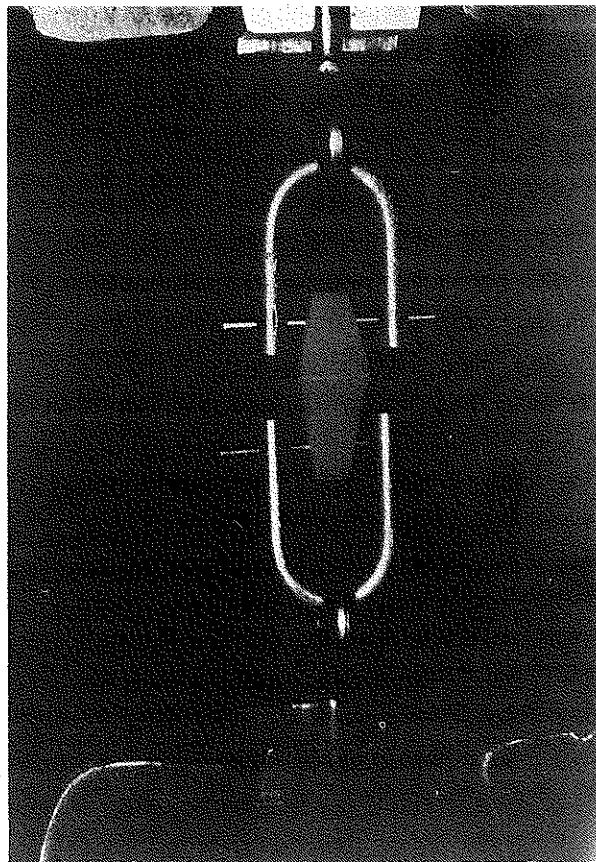

BULGULAR

Molloplast-B ile farklı akrilik protez kaide maddeinin bağlanma dayanımları ve yük altında kopma şekilleri Tablo II de görülmektedir. Varyans analizi sonuçlarına göre birbirinden farklı akrilik reçinelerin Molloplast-B ile bağlanma dayanımları arasında değişkenlik saptanmıştır (Tablo III).

Melioident polimerize edilerek Molloplast-B ile bağlandığında (I. Grup da) 12.91 kg/cm², polimerize

edilmeden Molloplast-B ile bağlandığında ise (II. Grup da) 10.95 kg/cm² ile en yüksek bağlanma dayanımlarını göstermiştir. Meliodent kopma şekli bakımdan, I. Grupda kohesiv, II. Grupda ise adeziv ayrılmıştır. Polimerize edilmiş Lucitone ve Compresin akrilik reçineler Meliodent'den istatistiksel olarak farklı bulunmamış ve kopma şekilleri de benzerlik göstermiştir (Tablo II) (Şekil 1).

Tablo II : Molloplast-B ile farklı akrilik protez kaide materyallerinin bağlanma dayanımları

Materyal	Polimerize akrilik (kg/cm ²)	Kopma şekli*	Polimerize edilmemiş akrilik(kg/cm ²)	Kopma şekli*
Pacton	7.99 (0.90)	A/C	8.97 (0.87)	A
Lucitone	12.76 (0.95)	C	7.61 (0.85)	A
Melioident	12.91 (1.17)	C	10.95 (0.88)	A
Compresin	11.47 (0.30)	C		
Ivocap	10.60 (1.84)	A/C		


* A=Adeziv, C=Kohesiv Deformasyon hızı=2mm/dak.
Parantez içerisindeki değerler standart sapmadır.

Tablo III: Molloplast-B ile farklı akrilik protez kaide materyallerinin bağlanma dayanımlarının Tukey analizi ile değerlendirilmesi

Materyel	Polimerize akrilik (kg/cm ²)	Polimerize edilmemiş akrilik (kg/cm ²)
Pacton	7.99	8.97
Lucitone	12.76	7.61
Melioident	12.91	10.95
Compresin	11.47	
Ivocap	10.60	

Her bir çizginin birleştiği ortalamalar istatistiksel olarak farklı değildir ($p < 0.05$).

Şekil 1.

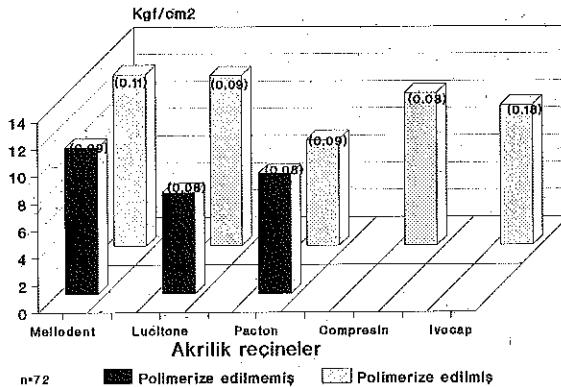

I. Gruptaki polimerize akrilik reçineler arasında en düşük bağlanma dayanımını Pacton, II. Gruptaki polimerize edilmemiş akrilik reçinelerden en düşük bağlanma dayanımını ise Lucitone göstermiştir. Moloplast-B ile bağlanan Meliodent, Pacton ve Lucitone akrilik reçinelerden sadece Pacton'un I. ve II Grup da bağlanma dayanımları arasında fark saptanmamıştır.

TARTIŞMA

Yumuşak astar maddelerinin protez kenarlarında akrilik kaideye ayrılmazı hijyenik olmayan bir ortam meydana getirmektedir. Dolayısıyla bu tür protezlerde astar maddesi ile akrilik kaide arasında maksimum adhezyon sağlanması önemlidir. Son yıllarda yumuşak astar maddeleri ile birlikte kırılmaya dirençli akrilik protez kaide maddelerinin kullanılması genel bir uygulama halini almıştır. Ancak pratikte bu uygulamanın dışına çıkma olasılığı her zaman vardır. Bu durumda farklı akrilik reçinelerden yapılmış protezlerin bir astar maddesi ile yeterli bağlanma sağlayıp sağlayamayacağı bu araştırmada aydınlatılmaya çalışılmıştır.

İncelenen akrilik protez kaide maddeleriyle yumuşak astar maddesi Moloplast-B arasında farklı bağlanma dayanımları saptanmıştır. Kırılma direnci yüksek olan Pacton ve Lucitone bu tür protezlerde sıkılıkla kullanıldığından, Pacton'un I. Grupda Lucitone'nun ise II. Grupta en düşük bağlanma dayanımını göstermeleri beklenmedik bir sonuç olmuştur. Diğer taraftan bu çalışmada en yüksek adezyon değerini polimerize edilmiş Meliodent göstermiştir. Meliodent ayrıca polimerize edilmiş Lucitone ve Compresin'den istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır. Ancak Ivocap ve Pacton'dan farklıdır. Dolayısıyla yumuşak astar maddeleriyle bağlanan akrilik reçinenin türü bağlanma kuvvetini etkileyebilmektedir. Bu bulgumuz Fowler'in (6) bulgularıyla paralellik göstermektedir.

Temelde benzer kimyasal yapıya sahip polimerler, molekül ağırlığı, çapraz bağ ajanının türü, glass transition temperature (katı veya camsı hale geçiş dereesi) gibi faktörlere bağlı olarak farklı fizikal özellikler göstermektedirler (10). Bu faktörlerin akrilik reçinelerin bağlanma dayanımlarını da etkileyebileceği düşünülmektedir.

Polimerize edilmemiş Meliodent ve Lucitone'un değerleri arasındaki fark anlamlı iken polimerize edildiklerinde aralarındaki fark öneksiz hale gelmiştir. Bu sonuç Meliodent'in bağlanma yüzeyinin polimerize olmamış halde iken Lucitone'a göre daha fazla moleküller bağ yapabildiğini göstermektedir.

Pacton'un bağlanma dayanımı polimerizasyon durumu ile (Grup I ve Grup II de) değişmemiştir. Bu göre Pacton'un pürüzlendirildiğinde Meliodent'den ve Lucitone'dan daha az moleküller bağ aktivitesi gösterdiği düşünülebilir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre polimerize pürüzlü Meliodent, Lucitone ve Compresin akrilik reçinelerle Moloplast-B'nin bağlanma dayanımları fark göstermemiştir ve kopma şekli kohesiv olarak saptanmıştır. Dolayısıyla yumuşak astar maddesinin maksimum çekme geriliminin, akriliklerle olan bağlanma dayanımlarından düşük olduğu anlaşılmıştır. Farris ve arkadaşlarının (5) Moloplast-B ve Lucitone ile elde ettikleri bulgular bizim elde ettigimiz sonuçlarımıza uygunluk göstermektedir.

Farklı akrilik reçinelerle bağlanarak hem adesiv hem kohesiv kopma gösteren Moloplast'in bağlanma dayanımları da esasında gerçek çekme gerilimi ile hemen hemen aynı kabul edilebilir. Moloplast-B bağlandığı polimerize pürüzlü Pacton ve Ivocap akrilik reçinelerle hem adesiv hem kohesiv kopma göstermiştir. Bu durumda bağlanmanın yine de yeterli olacağı kabul edilebilir.

Bates ve Smith(2) yaklaşık 5 kg'lık bir soyma kuvvetinin yumuşak astar maddelerinin klinik kullanım için yeterli olduğunu bildirmiştir. Ancak çekme gerilimi ile değerlendirme yapıldığında klinik kullanım için yeterli bir adezyon kuvvetinin daha yüksek olması beklenmelidir. Literatürde daha önce çekme gerilimi kullanılarak saptanmış yeterli bir adezyon değerine rastlanılmamıştır. Çalışmamızda elde ettigimiz en düşük ve en yüksek değerler literatürde Moloplast-B için bildirilen bağlanma dayanımı değerleriyle uygunluk göstermektedir(8,9,11).

Lucitone, Pacton ve Meliodent polimerize edilmemiş halde iken (II. Grup) adesiv kopma göstermişlerdir. Bu gruptaki bağlanma dayanım değerleri Pacton hariç akrilik yüzeylerin polimerize pürüzlü olduğu I. Grup'dan anlamlı olarak düşüktür. Pacton, II. Grup'daki polimerize edilmemiş değerleriyle karşılaştırıldığında I. Grup da daha fazla kohesiv kopma ancak beraberinde daha düşük bağlanma kuvveti göstermesi Moloplast'in çekme geriliminin stabil olmadığını belirtmektedir. Bu sonuç Moloplast'in akrilik reçineye bağlanmasının güvenilir olmadığını belirten Wright'in(13) bulgularını desteklemektedir. Ayrıca Moloplast'in stresleri bağlanma yüzeyine her tarafta eşit olarak iletmediği veya polimerize olduğunda her zaman homojen bir yapı göstermediği de düşünülmektedir.

Meliodent yapısal olarak çapraz bağlı konvansiyonel poli(metil metakrilat) akrilik reçinedir. Kırılma direnci yüksek akriliklerin (Lucitone ve Pacton) buta-

diene veya styrene türü elastomerlerle çapraz bağ yaparak güçlendirilmiş (rubber reinforced) oldukları belirtilmektedir(3). Ivocap polivinil akrilik reçine türündedir, Compresin ise dökülebilir otopolimerizan akrilik reçinedir. Dolayısıyla materyaller arasında saptanmış farklı bağlanma dayanımları öncelikle farklı kimyasal yapılarında olmalarından kaynaklabılır.

Fowler(6) incelediği farklı akrilik reçinelerden çapraz bağlı olmayanların adezyonlarının çok düşük bulunduğu bildirmiştir. Çalışmamızda kullandığımız akrilik protez kaide maddelerinin yapısal özellikleri konusunda bilgi talebimiz sadece Lucitone'un ve Ivocap'in firmaları tarafından kısmen karşılanmıştır(7). Bu nedenle yapısal farılıklardan kaynaklanabilecek değişimler kısıtlı olarak tartışılmıştır.

Deneysel kopma şekilleri yorumlandığında; eğer polimerize olmamış Meliodent, Lucitone ve Pacton akrilik protez kaide maddeleri Molloplast-B ile astarlanırsa çekme gerilimi altında yırtılma göstermeden protez kenarlarından ayrılacıkları söylenebilir. Bu akrilikler polimerize ve pürüzlü olduklarında ise Me-

liodent'in ve Lucitone'nun yırtılma, Pacton'un ise yırtılma ile beraber bağlanma yüzeyinden ayrılma göstergesi de beklenebilir. Eğer Compresin veya Ivocap akrilik protez kaide maddeleri Molloplast-B ile astarlanı ise çekme gerilimi altında astar maddesinin protez kenarlarından ayrılmadan kendi bünyesinde yırtacağı tahmin edilebilir.

SONUÇLAR

1- Molloplast-B en yüksek bağlanma dayanımını polimerize edilmiş ve pürüzlendirilmiş Meliodent akrilik reçine ile göstermiştir. Lucitone'un ve Compresin'in bağlanma dayanımları Meliodent'den istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır.

2- Kırılmaya dirençli akrilik reçineler olan Lucitone (II. Grupda) ve Pacton (I. Grupda) diğer akrilik reçinelerden düşük bağlanma dayanımı göstermişdir.

3- Akrilik yüzeylerin pürüzlendirilmesi Pacton hariç Meliodent ve Lucitone'nun bağlanma dayanımını artırmıştır.

4- Bir yumuşak astar maddesi olan Molloplast-B'nin, kırılma dayanımı yüksek olan akrilikler (Lucitone, Pacton) dışında konvansiyonel akriliklerle de yeterli bağlanma sağlayabileceği anlaşılmıştır.

KAYNAKLAR

- 1- Amin, W.M., Fletcher, A.M., Ritchie, G.M.: The nature of the interface between polymethyl methacrylate denture base materials and soft lining materials. *J Dent* 1981; **9**:336-46.
- 2- Bates, J. F., Smith, D.C.: Evaluation of indirect resilient liners for dentures; Laboratory and clinical tests. *J Am Dent Assoc* 1965; **70**:344-53.
- 3- Craig, R. G. : Restorative dental materials, 7.th Ed., The C.V. Mosby Co., St. Louis, 1985. 461-2.
- 4- Craig, R. G., Gibbons, P. : Properties of resilient denture liners. *J Am Dent Assoc* 1961; **63**:382-90.
- 5- Farris, C.L., Gentleman, L., Rawls, H.R. : Improvement of bonding strength of apolypophosphazine elastomer for denture liners. *J Dent Res* 1982; **61**:285.
- 6- Fowler, J. A. : A comparison of bonding strength characteristics between a silicone rubber Silastic 390 and various denture base resins, The University of Texas, Thesis, June 1968.
- 7- Kawano, F., Dootz, E. R., Koran, A., Craig, R. G. : Comparison of bond strength of six soft denture liners to denture base resin. *J Prosthet Dent* 1992; **68**:368-71.
- 8- Khan, Z., Martin, J., Collard, S. : Adhesion characteristics of visible light-cured denture base material bonded to resilient lining materials. *J Prosthet Dent* 1989; **62**:196-200.
- 9- Kutay, Ö. : Akrilik ve metal protez kaide maddelerine Molloplast-B'nin tutunması, İ. Ü. Diş Hek. Fak. Protetik Diş. Ted. A. B. Dahı, Doktora tezi, 1989.
- 10- Phillips, R.W. : Science of dental materials. 9.th Ed., W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1991;172-175.
- 11- Storer, R. : Resilient denture base materials. Part I; Introduction and laboratory evaluation. *Br Dent J* 1963;195-203.
- 12- Şenocak, M.: Temel biyoistatistik, 1. baskı, Çağlayan kitapevi, İstanbul, 1990.
- 13- Wright, P.S. : Characterization of the adhesion of soft lining materials to poly methylmethacrylate. *J Dent* 1982; **61**:1002-5.

Yazışma adresi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutay
İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
34390 Çapa - İstanbul